

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi

Sayı : 11321972/
Konu : Teklife Davet

21.08.2020

PİYASA ARAŞTIRMA ve TEKLİF MEKTUBU

Hastanemiz ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen, 5 Kalem Mefruşat Alımı yapılacaktır. Belirtilen şartlara göre düzenlenecek teklifinizin en geç 25.08.2020 tarihi saat 16:00 a kadar Satın Alma Birimine teslimini rica ederim.

Utman YAŞARER
Müdür Yardımcısı

TEL : 0414 318 79 00

MEAIL : satinalmaharran@gmail.com

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S.NO	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	MIKTAR	BİRİM	Teklif Edilen	Teklif Edilen Toplam Tutar
1	75x145 Nevresim(sadece çarşaf)	100	Adet		
2	67x160 Nevresim(sadece çarşaf)	30	Adet		
3	90x190 Nevresim(sadece çarşaf)	150	Adet		
4	56x40 Yastık Kılıfı	150	Adet		
5	Pike	100	Adet		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Ek: Teknik Şartname (.....Sayfa)


- 1-Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- 2-Teklif edilecek fiyatlar "KDV" hariç olarak belirtilecektir.
- 3- İdare, verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda değildir.
- 4-Satın alınacak malzemelerin Fatura tutarı üzerinden %0,948 damga vergisi alınacaktır.
- 5--Ödemeler İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi ödeme planına göre yapılacaktır.
- 6-Malzemeler, firmaya faks yolu ile yapılan tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde idareye teslim edilecektir.
- 7-Söz konusu iş için ayrıca işçilik ve montaj ücreti ödenmeyecektir.
- 8-Malzemeler Harran Devlet Hastanesi ambarlarına teslim edilecek.
- 9-Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Harran Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10-Teklif konusu işin (.....kalemlerini) KDV hariç (Rakam ile).....TL.(Yazı ile).....
..... bedel karşılığındagün içerisinde vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Teklif mektubunuzu onaylayarak teknik şartnamenizi de kabul etmiş olduğumu beyan ederim.


HARRAN DEVLET HASTANESİ NEVRESİM, YASTIK KILIFI İLE PİKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

NEVRESİM(sadece çarşaf):

ÇOCUK YATAKLARI

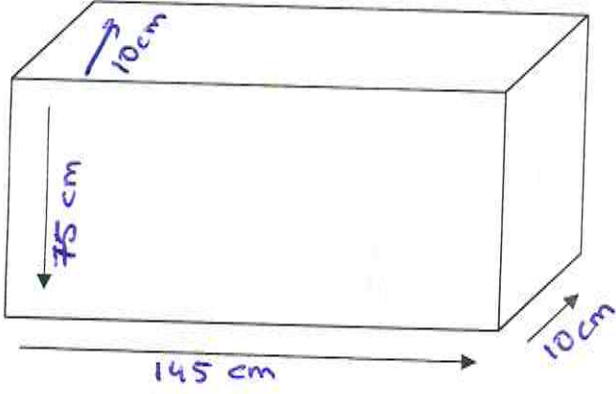


20 Yatak

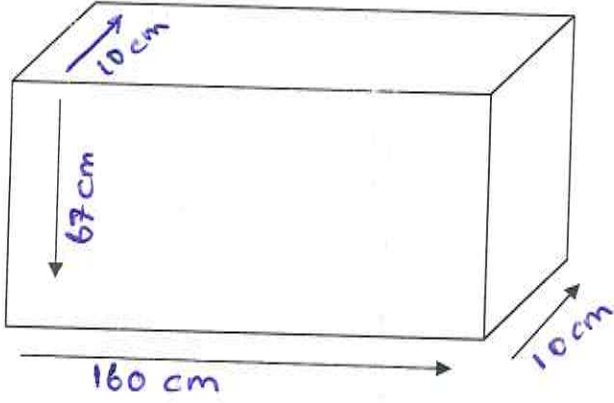

7 Yatak

YETİŞKİN YATAKLARI: 30 ADET

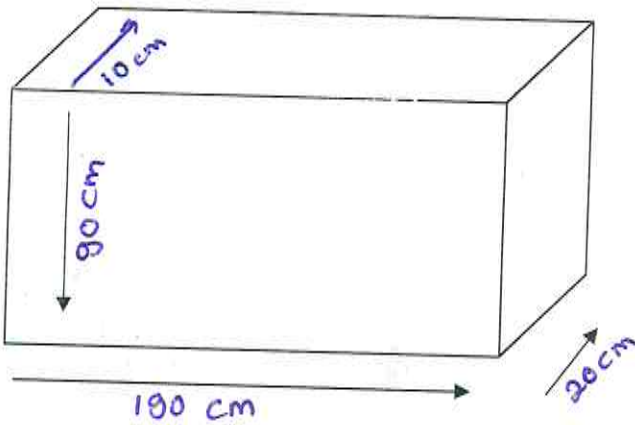

30 Yatak

- Kumaş, 70 dereceye kadar ısıda yıkamada dayanıklı olacaktır.
- 70 derece yıkamada çekme payı çözgü yönünde %3 den , atkı yönünde %1 den fazla olmamalıdır.
- Her çarşaf jelatin ambalajla ve üstünde ebat etiketi olacaktır.

Utman YASAR
Harran Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı

- Her çarşafın üstünde sağlık bakanlığı logosu bulunacaktır.
- Çocuk çarşafları lastik dikimli olacaktır.
- Sağlık bakanlığı amblemi ile Harran Devlet Hastanesi amblemi idarenin belirleyeceği yerde olacaktır.
- Renk seçimi idare tarafından belirlenecektir.
- Kullanım hatası dışındaki kumaştaki hatalar için yüklenici firma değişim garantisi verecektir.
- Seri baskıya başlamadan önce yüklenici firma hastaneye bir numune getirecektir.

YASTAK KILIFLARI

- Kumaş, 70 dereceye kadar ısıda yıkamada dayanıklı olacaktır.
- 70 derece yıkamada çekme payı çözgü yönünde %3 den , atkı yönünde %1 den fazla olmamalıdır.
- Renk seçimi idare tarafından belirlenecektir.
- Kullanım hatası dışındaki kumaştaki hatalar için yüklenici firma değişim garantisi verecektir.
- Seri baskıya başlamadan önce yüklenici firma hastaneye bir numune getirecektir.
- Yastık kılıfları jelatin ambalajda ve üstünde ebat etiketi olacaktır.
- 56*40 ebatlarında olacaktır.

PIKE

- %100 pamuk olmalıdır.
- Ortalama ağırlık 1000 gr.(+ 10gr) olmalıdır.
- Kenar Katlamaları 2 cm ve 4 köşeden olmalıdır.
- Hastaneye bir adet numune verilmelidir.
- Kullanım hatası dışındaki kumaştaki hatalar için yüklenici firma değişim garantisi verecektir.

* En 160 cm boy 220
• 70 derece yıkamada çekme payı çözgü yönünde %3 den, atkı yönünde %1 den fazla olmamalıdır.

Utman YAŞAR
Harran Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı

T